

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY 0249—1996

药用软膏铝管

Aluminum tube for medicinal ointment

1996-12-30 发布

1997-07-01 实施

国家医药管理局 发布

前 言

本标准等效采用英国标准 BS 2006—84《铝质软管》。本标准根据药品的包装要求,增加了内涂层化学稳定性、印刷质量、尾涂均匀性、管帽配合、菌检和异常毒性六项技术指标。除此之外,本标准与 BS 2006主要有以下不同:

- a) 本标准对管身长度未作规定,薄顶厚度尺寸公差严于 BS 2006;
- b) 内涂层连续性指标高于 BS 2006;
- c) 封闭性的试验方法中空气压力由 0.02 MPa 提高到 0.2 MPa。

本标准由国家医药管理局提出。

本标准由国家医药管理局山东医药包装材料、容器产品质量检测中心归口。

本标准起草单位:上海实业马利画材有限公司、上海新亚药业公司金山分厂、上海市医药管理局药品测试所。

本标准主要起草人:王余仁、吕荣华、朱五华。

中华人民共和国医药行业标准

药用软膏铝管

YY 0249—1996

Aluminum tube for medicinal ointment

1 范围

本标准规定了药用软膏铝管的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。本标准适用于盛装软膏剂的铝管。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 191—90 包装储运图示标志

GB 2828—87 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)


GB 2829—87 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

GB 6543—86 瓦楞纸箱

中华人民共和国药典 一九九五年版二部

3 产品分类

药用软膏铝管(以下简称铝管)由铝质管体(如图1所示)和塑料管帽两部分组成。

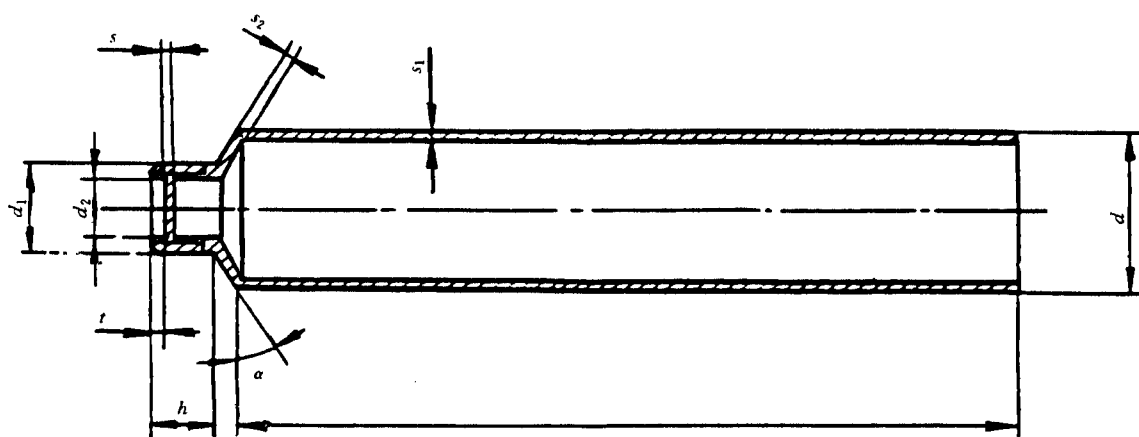

d —直径; d_1 —口外径; d_2 —口内径; s —薄顶厚度; s_1 —壁厚;
 s_2 —肩厚; l —长度; h —管口长度; t —螺距; α —肩角

图1 铝管主要部位图示